GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LAMPADA FRONTALE MEDICA A LED GIMA 80 KL 5W
LAMPADA CHIRURGICA A LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL LED MEDICAL HEADLIGHT 5W
GIMA 50 KL SURGICAL LED HEADLIGHT 5W
LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 80 KL GIMA 5W
LAMPE FRONTALE CHIRUGICALE À LED 50 KL GIMA 5W
LÁMPARA FRONTAL MÉDICA DE LED GIMA 80 KL 5W
LÁMPARA FRONTAL QUIRÚRGICA DE LED GIMA 50 KL 5W
FOTÓFORO LED GIMA 80 KL5W
FOTÓFORO LED CIRÚRGICO GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL MEDIZINISCHE LED-STIRNLEUCHTE 5W
GIMA 50 KL CHIRURGISCHE LED-STIRNLEUCHTE 5W
MEDYCZNA LAMPA CZOŁOWA LED 80 KL GIMA 5W
CHIRURGICZNA LAMPA CZOŁOWA LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W
GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W
LAMPĂ MEDICALĂ FRONTALĂ CU LED GIMA 80 KL 5W
LAMPĂ CHIRURGICALĂ FRONTALĂ CU LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL LED MEDICINSK HUVUDLAMPA 5W
GIMA 50 KL KIRURGISK HUVUDLAMPA 5W
GIMA 80 KL LED LEKÁRSKE ČELOVÉ SVIETIDLO 5W
GIMA 50 KL CHIRURGICKÉ LED ČELOVÉ SVIETIDLO 5W
GIMA 80 KL LED MEDICINSKA SVJETILJKA ZA GLAVU 5W
GIMA 50 KL KIRURŠKA LED SVJETILJKA ZA GLAVU 5W
GIMA 80 KL ORVOSI LED-FEJLÁMPA 5W
50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5W
GIMA 80 KL LED-PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 5W
GIMA 50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W

	REF
GIMA 30873	**KS-H1N**
GIMA 30936	**KS-W02**

Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd
5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou, China - Made in China

EU REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M30873-M-Rev.5-09.26

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

1. Εισαγωγή

Όνομα: Ιατρικός Φωτισμός LED Μοντέλο: Σειρά KS

Ο φωτισμός παρέχει στον χρήστη μια πολύ ομοιόμορφη δέσμη η οποία δεν παρουσιάζει καμία χρωματική μεταβολή σε όλο το εύρος του βάθους πεδίου των μεγεθυντικών λουπών. Ο λαμπτήρας κεφαλής, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στη μονάδα της μπαταρίας, διαθέτει ομαλή ρύθμιση της έντασης του φωτισμού. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στον χρήστη να έχει ακριβή έλεγχο της φωτεινότητας του λαμπτήρα κεφαλής, έτσι ώστε να μπορεί να διακρίνει οποιαδήποτε λεπτομέρεια

Τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων των MDR 2017/745, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1- 2:2014, IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-2-41

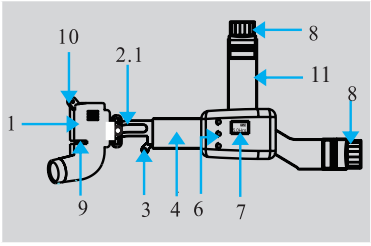
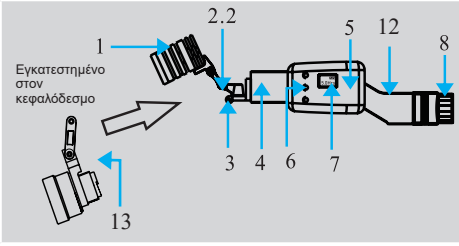
2. Κύρια Χρήση

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση εξέτασης που απαιτεί υψηλό φωτισμό, υψηλή αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανήματος και μεταβαλλόμενη συχνότητα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε οδοντιατρεία, χειρουργεία, ιατρεία και σε δομές ιατρικής περίθαλψης.

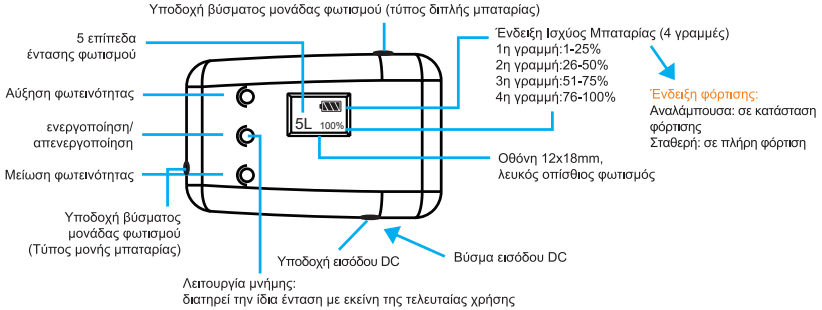
3. Μοντέλα και Τεχνικά δεδομένα

Μοντέλο	**KS-W02(5W)**	**KS-H1N (5W)**
Κεφαλή λαμπτήρα		
Αρχή	Οπτική διαδρομή σχήματος L Πολυ-οπτικός φακός Εσωτερικό φράγμα φωτός	Οπτική διαδρομή ίσιου σχήματος Απλός μονός οπτικός φακός Εξαιρετικά υψηλός φωτισμός
Ένταση φωτισμού	10,000~50,000lux	20,000~100,000lux
Διάρκεια ζωής LED	50.000 ώρες	50.000 ώρες
Διάμετρος πεδίου φωτισμού	Μεταβλητή από D=50mm έως D=100mm	D=135mm@50cm
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	1,8 ώρες-2 ώρες	1,8 ώρες-2 ώρες
Συνεχόμενος χρόνος λειτουργίας	2,5 ώρες-20 ώρες	2,5 ώρες-20 ώρες
Στάνταρ διαμόρφωση	Πλήρης κεφαλόδεσμος με μία μπαταρία	Μισός κεφαλόδεμος με μία μπαταρία

4. Σκελετός φωτισμού κεφαλής

Model: KS-W02	Model: KS-R01
	

1. κεφαλή φωτισμού 2.1 αρθρωτός σύνδεσμος για κίνηση προς κάθετη & οριζόντια κατεύθυνση 2.2 Κατευθυντικό φως 3. σύνδεσμος εγκατάστασης μεγεθυντικής λούπας 4. αφαιρούμενο αντιιδρωτικό δερμάτινο υλικό 5. Κουτί μπαταρίας λιθίου 6. Κουμπιά ελέγχου 7. Οθόνη LED 8. κουμπί ρύθμισης στεφανιού κεφαλής 9. ρύθμιση μεγέθους σημείου φωτισμού 10. Σύνδεσμος εγκατάστασης κάμερας 11. πλήρες στεφάνι 12. μισό στεφάνι 13. μεγεθυντικές λούπες με αρθρωτό σύνδεσμο



Για την ασφαλή χρήση, δεν επιτρέπεται να φορτίζετε τη μπαταρία όταν αυτή χρησιμοποιείται για τον φωτισμό. Εάν συνδεθεί σε αυτή την υποδοχή, η μπαταρία δεν θα λειτουργεί για τον φωτισμό αλλά μόνο θα φορτίζεται

5. Συνθήκες Λειτουργίας

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 5°C ~ +40°C

Σχετική Υγρασία: <85%

Ατμοσφαιρική Πίεση: 700hPa ~ 1060hPa

6. Παρατήρηση

6.1 Αυτό το προϊόν δεν διαθέτει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον πελάτη. Μην το αποσυναρμολογείτε εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα.

6.2 Τα σημεία σύνδεσης κάθε συνδεόμενου μέρους του προϊόντος πρέπει να ελέγχονται συχνά ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα λόγω χαλαρότητας.

6.3 Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία και σε εύφλεκτους χώρους.
6.4 Σε περίπτωση που υπάρχει βρωμιά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό και έπειτα σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
6.5 Κατά τη χρήση ή τη συντήρηση, μην αγγίζετε τους φακούς απευθείας με τα δάχτυλά σας και διατηρείτε πάντα τους φακούς καθαρούς.
6.6 Απορρίψτε τη μπαταρία σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μην την απορρίπτετε στο περιβάλλον.
6.7. Αποθήκευση των μπαταριών

Οι μπαταρίεςπρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου και να είναι φορτισμένες σε ποσοστό 30% έως 50% περίπου.

Οι μπαταρίες συνιστάται να φορτίζονται περίπου μια φορά το εξάμηνο ώστε να αποτρέπεται η υπερβολική εκφόρτιση.

7. Εγγύηση και Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

7.1. Εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αποστολής
- Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης (εφόσον το ελάττωμα οφείλεται στην ποιότητα του προϊόντος), ο καταναλωτής δικαιούται δωρεάν συντήρηση, κατόπιν προσκόμισης του δελτίου εγγύησης και του τιμολογίου.
- Σε περίπτωση εγκατάστασης άλλων εξαρτημάτων, δίχως τη σχετικη έγκριση του κατασκευαστή, το ελάττωμα δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Σε περίπτωση που οι σημάνσεις επάνω στο προϊόν, όπως ο αριθμός μοντέλου ή η ημερομηνία κατασκευής, έχουν τροποποιηθεί, σβηστεί, μετακινηθεί ή δεν είναι αναγνωρίσιμες, παύει να ισχύει η δωρεάν υπηρεσία συντήρησης.
- Βλάβες που προκαλούνται από πτώση, σύνθλιψη, βύθιση σε υγρό, υγρασία και άλλους ανθρώπινους παράγοντες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

7.2. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
Οι πελάτες πρέπει να παρέχουν τους κωδικούς των προϊόντων, καθώς και φωτογραφία ή βίντεο προκειμένου να επιβεβαιωθεί το πρόβλημα. Εφόσον το πρόβλημα επιβεβαιωθεί, εάν η επίλυσή του είναι εύκολη, αποστέλλουμε το ανταλλακτικό στον πελάτη. Εάν το πρόβλημα δεν δύναται να επιλυθεί, προβλέπεται επιστροφή ή εκ νέου αποστολή.

8. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος αλλά το φως δεν ανάβει	Κακή σύνδεση	Συνδέστε τη μπαταρία
		Συνδέστε με την κεφαλή φωτισμού
	Ελαττωματική μπαταρία	Ελέγξτε την οθόνη LED στη μπαταρία
	Ελαττωματικό PCB	Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή
Η φωτεινότητα δεν μπορεί να ρυθμιστεί	Ελαττωματικό PCB	Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή

9. Σύμβολα

CE	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/745	REF	Κωδικός προϊόντος
	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)	LOT	Αριθμός παρτίδας
	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης		Παραγωγός
	Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία
	Διάθεση WEEE	04 PE-LD	Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
	Ημερομηνία παραγωγής	MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Εισαγωγή από	EU REP	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
UDI	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής		Εύθραυστο, χειρίζεστε με προσοχή
	Χωρητικότητα μπαταρίας		Προειδοποίηση
	Ανακύκλωση	SN	Σειριακός αριθμός
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού		αυτή είναι η πάνω πλευρά

ΧΩΝΕΥΣΗ: *Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζύ με άλλα απορρύματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τες σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών..*

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.