GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LAMPADA FRONTALE MEDICA A LED GIMA 80 KL 5W
LAMPADA CHIRURGICA A LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL LED MEDICAL HEADLIGHT 5W
GIMA 50 KL SURGICAL LED HEADLIGHT 5W
LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 80 KL GIMA 5W
LAMPE FRONTALE CHIRUGICALE À LED 50 KL GIMA 5W
LÁMPARA FRONTAL MÉDICA DE LED GIMA 80 KL 5W
LÁMPARA FRONTAL QUIRÚRGICA DE LED GIMA 50 KL 5W
FOTÓFORO LED GIMA 80 KL5W
FOTÓFORO LED CIRÚRGICO GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL MEDIZINISCHE LED-STIRNLEUCHTE 5W
GIMA 50 KL CHIRURGISCHE LED-STIRNLEUCHTE 5W
MEDYCZNA LAMPA CZOŁOWA LED 80 KL GIMA 5W
CHIRURGICZNA LAMPA CZOŁOWA LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W
GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W
LAMPĂ MEDICALĂ FRONTALĂ CU LED GIMA 80 KL 5W
LAMPĂ CHIRURGICALĂ FRONTALĂ CU LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL LED MEDICINSK HUVUDLAMPA 5W
GIMA 50 KL KIRURGISK HUVUDLAMPA 5W
GIMA 80 KL LED LEKÁRSKE ČELOVÉ SVIETIDLO 5W
GIMA 50 KL CHIRURGICKÉ LED ČELOVÉ SVIETIDLO 5W
GIMA 80 KL LED MEDICINSKA SVJETILJKA ZA GLAVU 5W
GIMA 50 KL KIRURŠKA LED SVJETILJKA ZA GLAVU 5W
GIMA 80 KL ORVOSI LED-FEJLÁMPA 5W
50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5W
GIMA 80 KL LED-PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 5W
GIMA 50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W

	REF
GIMA 30873	**KS-H1N**
GIMA 30936	**KS-W02**

Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd
5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou, China - Made in China

EU REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M30873-M-Rev.5-09.26

Minden, az általunk szolgáltatott orvostechnikai eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet jelenteni kell a gyártó felé és annak a tagállamnak a hivatalos szerve felé, ahol az Ön székhelye található.

1. Bevezetés

Név: Orvosi LED-fejlámpa modell: KS-sorozat

A lámpa rendkívül egyenletes fénysugarat biztosít a felhasználó számára, amely a nagyítóüvegek mélységélességi tartományában semmilyen színváltozást nem mutat. Az akkumulátoregységbe építve a fejlámpa lépésmentes fényerő-szabályozással rendelkezik. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára a fejlámpa fényerejének pontos szabályozását, biztosítva a legapróbb részletek megtekintését

Megfelel az MDR 2017/745, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-6:2010 és IEC 60601-2-41 szabványok előírásainak.

2. Elsődleges használati útmutató

Olyan helyi vizsgálatokhoz tervezve, amelyek nagy megvilágítást, közvetlen kezelhetőséget és gyakori mozgatást igényelnek. Leggyakrabban a fogászatban, műtőkben, beteglátogatások során és terepi orvosi ellátásban használatos.

3. Modell és műszaki adatok

Modell	KS-W02(5W)	KS-H1N (5W)
Lámpafej		
Működési elv	L alakú fényút, többszörös optikai lencse, belső fényrács	Egyenes fényút, többszörös optikai lencse, legalacsonyabb teljesítmény
Fényerősség	10 000~50 000 lux	20 000~100 000 lux
LED élettartama	50 000 óra	50 000 óra
Fényfolt átmérője	Változtatható D = 50 mm–100 mm között	D = 135 mm 50 cm távolságból
Akkumulátor töltési ideje	1,8 óra–2 óra	1,8 óra–2 óra
Folyamatos működési idő	2,5 óra–20 óra	2,5 óra–20 óra
Szabványos konfiguráció	Teljes fejpánt 1 akkumulátorral	Félig nyitott fejpánt 1 akkumulátorral

4. Fejlámpa kerete / vázszerkezete

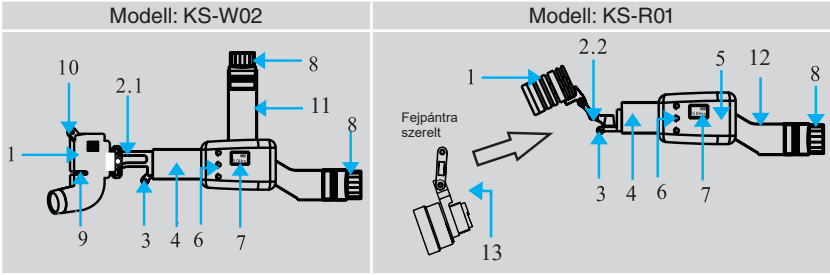

1. Lámpafej 2.1 Csuklópánt a függőleges és vízszintes irányú mozgatáshoz 2.2 Irányított, fókuszált fényrögzítés 3. Lupe rögzítőcsukló 4. Cserélhető, izzadsággátló bőrcsík 5. Lítium akkumulátorház 6. Kezelőgombok 7. LED kijelző 8. Fejpánt pántállító gombja 9. Fényfolt méretét állító gomb 10. Kamera rögzítőcsukló 11. Teljes pánt 12. Félpánt 13. Lupék összekötő csuklóval

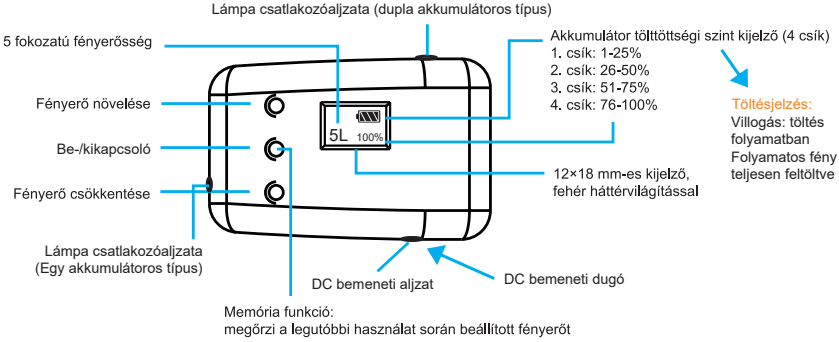

A biztonságos használat érdekében az akkumulátort nem szabad tölteni, miközben az a lámpát működteti. Ha ez az aljzat csatlakoztatva van, az akkumulátor nem táplálja a lámpát, csak töltődik

5. Üzemi körülmények

Környezeti hőmérséklet: 5°C ~ +40°C

Relatív páratartalom: <85%

Légköri nyomás: 700hPa ~ 1060hPa

6. Megjegyzés

6.1 A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Meghibásodás esetén kérjük, ne szerelje szét a készüléket.

6.2 A termék egyes csatlakozó részeinek rögzítőelemeit rendszeresen ellenőrizni kell a

kilazulás miatti balesetek megelőzése érdekében;

6.3 Ne használja a terméket magas hőmérsékletű, magas páratartalmú és gyúlékony helyeken;

6.4 Szennyeződés esetén szárítsa meg, vagy használjon kevés semleges tisztítószerrel megnedvesített puha törlőkendőt, majd törölje át egy száraz kendővel.

6.5 Akár használat, akár karbantartás során, kérjük, ne érintse meg a lencsét közvetlenül az ujjaival, és mindig tartsa tisztán a lencsét;

6.6 A használt akkumulátort a vonatkozó előírásoknak megfelelően kezelje, kérjük, ne dobja a háztartási hulladékba.

6.7 Az akkumulátorok tárolása

Az akkumulátorokat szobahőmérsékleten, kb. 30-50%-os töltöttségi szinten kell tárolni.

A mélykisülés megelőzése érdekében javasoljuk az akkumulátorok körülbelül félévente történő feltöltését.

7. Jótállás és értékesítés utáni szerviz

7.1. 12 hónap garancia a berakodási kikötőtől számítva

- Rendeltetésszerű használat esetén a garanciális időszakban a termékminőségből eredő meghibásodásokra a fogyasztó a garanciajegy és a számla bemutatásával ingyenes karbantartási/javítási szolgáltatásra jogosult.
- Gyári engedély nélküli egyéb funkciók beszerelése esetén a meghibásodás nem tartozik a jótállás hatálya alá.
- Amennyiben a terméken lévő jelöléseket (pl. modellszám, gyártási dátum) módosították, törölték, eltávolították vagy azonosíthatatlanná tették, a termék nem jogosult ingyenes karbantartásra.
- A leejtés, összenyomás, átázás, nedvesség és egyéb emberi tényezők által okozott meghibásodások nem tartoznak a garancia hatálya alá.

7.2. Vevőszolgálat

A vásárlóknak meg kell adniuk a termékkódokat, valamint képet vagy videót kell küldeniük, amely segít a probléma beazonosításában. A probléma visszaigazolása után, ha az könnyen javítható, pótalkatrészt küldünk a ügyfélnek a probléma elhárítására. Ha a probléma nem javítható, mérlegeljük a vételár visszatérítését vagy a termék cseréjét.

8. Hibaelhárítás

Probléma	Hibaelemzés	Felbontás
A kapcsoló be van kapcsolva, de a lámpa nem világít	Hibás csatlakozás	Csatlakoztassa az akkumulátorhoz
		Lámpafej vezetéke
	Az akkumulátor hibás	Ellenőrizze a LED-kijelzőt az akkumulátoron
	Hibás vezérlőpanel	Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval
A fényerő nem állítható	Hibás vezérlőpanel	Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval

9. Szimbólumok

CE	Orvostechnikai eszköz, amely megfelel a 2017/745/EU rendeletnek	REF	Termékkód
	Vigyázat: figyelmesen olvassa el az utasításokat (figyelmeztetéseket)	LOT	Cikkszám
	Kövesse a használati utasításokat		Gyártó
	Száraz, hűvös helyen tartandó		Napfénytől tartsa távol.
	Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítása	04 PE-LD	Alacsony sűrűségű polietilén
	Gyártás dátuma	MD	Orvostechnikai eszköz
	Importálta	EU REP	Hivatalos képviselő az Európai Unióban
UDI	Az eszköz egyedi azonosítója		Óvatosan kezelendő
	Akkumulátor kapacitása		Figyelem
	Újrafeldolgozás	SN	Sorozatszám
	Világítás be/ki		Ez az oldal felfelé



Ártalmatlanítás: *Tilos a terméket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználóknak gondoskodniuk kell a selejtezésre váró készülékek ártalmatlanításáról az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadással.*

GIMA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Jótállás: a vásárlás dátumától számított 12 hónap