GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MISURATORE DI PICCO DI FLUSSO
PEAK FLOW METER
SPIROMÈTRE DE CRÊTE
MEDIDOR DE FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO
MEDIDOR DE PICO DE FLUXO
PEAK-FLOW-METER
TOPPFLÖDESMÄTARE
ΡΟΟΜΕΤΡΟ

Taian Dalu Medical Instrument Co., Ltd.
No. 3988 Yitianmen Street, Hi-tech Zone,
Taian Shandong, China 271000
sales@charamedical.com - www.dalumedical.com
Made in China

GIMA 33679 - 33680

REF **DL-F03, DL-F04**

EU REP Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10
1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands
info@lotusnl.com

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por
Importiert von / Importerad av / Εισαγωγή από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MD

CE 0197

M33679-M-Rev.2-05.25

Läs all information i denna manual före användning av toppflödesmätaren.

Försiktighetsföreskrift:
1. Toppflödesmätaren rekommenderas för användning av endast en patient.
2. Toppflödesmätaren ska användas under översyn av en licensierad sjukvårdspersonal.
3. Om enheten för topputandningsflöde används längre än dess specificerade livslängd, kan enhetens precision försämras.
4. Användning av enheten bör begränsas till endast utandning

Obs! Patientsymptom har företräde framför avläsningarna av toppflödesmätaren.

Inställning av verkningszoner
Zonmarkörer kan ställas in med en styluspenna av sjukvårdspersonalen för att ge personliga gränser för att genomför verkningsplanen för astma.

Att använda Toppflödesmätaren
1. Skjut ner markören till längst ner på skalan.
2. Håll enheten horisontellt framför din mun.
3. Andas in så djupt du kan.
4. Stäng läpparna tätt kring munstycket.
5. Blås ut så HÅRT och så SNABBT som möjligt i en sekund eller längre.
6. Se till så att tungan eller tänderna inte hindrar luftflödet. Salivstänk eller hosta kan ge felaktiga avläsningar.
7. Anteckna avläsningen.
8. Upprepa steg 1till 7 tre gånger och registrera det högsta avlästa värdet.
9. Vidta åtgärder enligt din personliga astmahanteringsplan.

Rengöring
Rengör de utvändiga ytorna efter användning. Vi rekommenderar att använda en vanlig spritsudd (75%). Var särskilt noga med området kring munstycket.

Indikationer för användning
Enheten mäter topputandningsflöde (PEF) på vuxna och barn från 5 år och över, i primärvård, kliniker, sjukhus och hemma, under övervakning av vårdpersonal. Enheten för topputandningsflöde kan användas för att övervaka framgång i behandlingen av astma, avgöra astmans svårighetsgrad, kontrollera svar på behandling under ett akut astmaanfall, upptäcka försämring av lungfunktion och undvika möjliga svåra astmautbrott.

Kontraindikationer, Varningar, Försiktighetsåtgärder och Biverkningar
- Denna enhet är avsedd att hjälpa dig att bedöma hur väl din astma är under kontroll genom att mäta ditt toppflöde som sedan kan övervakas med tiden.
- Försök aldrig att demontera enheten. Detta kan orsaka felaktiga värden för Topputandningsflödet.
- Om du tror att enheten inte avläser korrekt, fråga omedelbart din vårdpersonal
- Alla allvarliga händelser som inträffat i samband med enheten ska meddelas Taian Dalu eller dess auktoriserade representant och landets tillsynsmyndigheter.

Avyttring
Toppflödesmätaren och dess tillbehör utgör minimalt smutsigt avfall från mänsklig sjukvård och ska avyttras i enlighet med lokala bestämmelser.

Hållbarhet
3 år

Tekniska specifikationer
Produkt: Toppflödesmätare
Modell nr.: DL-F03, DL-F04
Material: ABS.plast
Avsedd användning: Mät maximalt expiratoriskt flöde för att övervaka andningsförhållandena.
Linjäritet: Skillnaden mellan medelfelet vid två på varandra följande test
Flödeshastigheterna får inte överstiga 5 % av den största av de två testflödena. Under ambient
förhållanden ska PEFM-avläsningen vid varje toppflödeshastighet i mätområdet
inte variera med mer än 10L/min eller 5 % av medelvärdet av avläsningarna, beroende på vilket som är
större.
Flödesmotstånd: Flödesmotståndet över mätområdet för
PEFM får inte överstiga PEFM 0,36KPa/(L/s) [0,006kPa/(L/min)].
Mätfel: Det största tillåtna felet ska vara ±10L/min eller ±10% av avläsningen, beroende på vilket som är störst.
Frekvenssvar: Skillnaden mellan det angivna PEF-värdet för A och B ska, för en identisk referens-PEF, inte
överstiga 15 l/min eller 12 %, beroende på vilket som är störst.
Högsta flödesresistens: DL-F03: 0.20KPa/(L/s) @720L/min; DL-F04: 0.24KPa/(L/s) @200L/min.


Mätområde: DL-F03: 60~800L/min,
DL-F04: 50~400L/min
Förvaringsförhållanden: förvara på en ren och torr plats
Transportförhållanden: Temperatur: 0-50°C
Relativ luftfuktighet: 10%-95%
Toppflödesmätarens prestandastandarder: EN ISO 23747:2015
Maximalt antal användningar: 7000 gånger


Storlek/Vikt

Modell DL-F03: L155mm*W48mm*H28mm/55g
Modell DL-F04: L155mm*W48mm*H28mm/55g

Förpackningens innehåll

Toppflödesmätare, Bruksanvisning

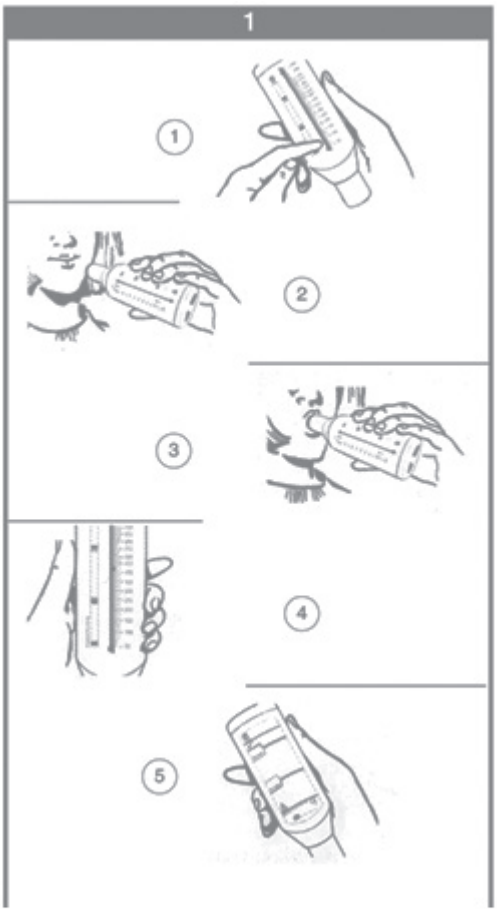

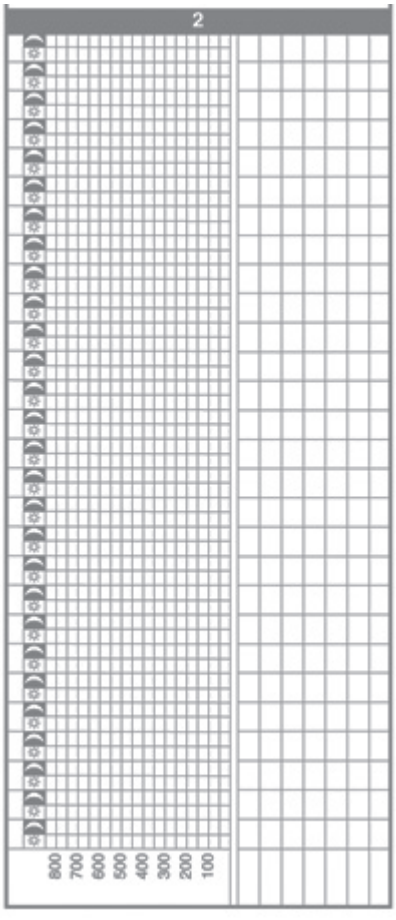

Symbolernas betydelse

REF	Produktkod		Skyddas från solljus		Läs bruksanvisningen
LOT	Satsnummer		Förvara på svalt och torrt ställe		Tillverkningsdatum
	Tillverkare	CE	Medicinsk utrustning i enlighet med förordning (EU) 2017/745	EU REP	Befullmäktigat ombud
MD	Medicinsk anordning		Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga	UDI	Unik enhetsidentifierare

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.