Besmed Silicone Cushion Mask



Besmed

No.5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd., Wu-Ku District,
New Taipei City, Taiwan 24888
Tel:886-2-2290-3959
Fax:886-2-2299-9076
E-mail:info@besmed.com
Web-site:www.besmed.com

CE 0344

501-86221-00114 Rev.0 2025-09

Besmed


Mascarilla con cojín de silicona Besmed
Con manguito inflable

1. Advertencias
La legislación federal de Estados Unidos preceptúa que el presente dispositivo se venda exclusivamente a aquéllos que presenten la prescripción de un facultativo, colegiado en EE.UU.
Su uso debe estar a cargo exclusivamente del personal especializado en las técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). En especial, es aconsejable que el personal, que usará la mascarilla, se ejercite a fin de aprender a aplicarla de la manera adecuada, para obtener la estanqueidad correcta. Cerciórese de que el personal conozca el contenido del presente Manual.

2. Descripción
El uso de la Mascarilla con cojín de silicona Besmed está indicado para los reanimadores manuales, los reanimadores automáticos y los ventiladores de reanimación.

Las tallas 2, 3, 4, 5 y 6 vienen de fábrica con un conector ISO de 22 mm. Se pueden esterilizar repetidamente en autoclave a 134º C. A través de la cúpula transparente, es posible controlar las condiciones del paciente.
Además, es posible regular el nivel de presión del manguito blando.

■ MASCARILLA CON COJÍN DE SILICONA



3. Modalidades de empleo

Ventilación mediante mascarilla con cojín

Aplique firmemente la mascarilla contra el rostro del paciente, cerciorándose de que ha obtenido la estanqueidad adecuada. Mantenga la mascarilla apretada con firmeza, contra el rostro del paciente y, al mismo tiempo, cerciórese de que la cabeza esté inclinada de manera tal que las vías respiratorias permanezcan abiertas.

4. Limpieza, desinfección y esterilización

Método			Aplicable
Limpieza	Lavado	Lavado manual	✓
		Lavado automático	✓
	Desinfección	Desinfección mediante lavado automático en caliente	✓
		Por hervor	✓
		Química	✓
	Autoclave	121°C	✓
		134°C	✓

En la tabla se aprecian los métodos indicados para efectuar la limpieza, desinfección y esterilización de la mascarilla cada vez que la usa.

Detergentes y desinfectantes químicos


En el mercado están disponibles varias marcas de detergentes y desinfectantes químicos. Emplee exclusivamente aquellas marcas que resulten compatibles con los materiales de la mascarilla, a efectos de que no se menoscabe la longevidad de los mismos.

Nota: Los restos de detergente o desinfectante que queden en la mascarilla, de no secarse, pueden corroer la superficie de la misma y, por consiguiente, acortar su longevidad.

4.1 Desmontaje de la mascarilla (recomendado)

Desenganche o extraiga el manguito de la mascarilla de la cúpula.

¡Cuidado! Antes de lavar la mascarilla en el autoclave, extraiga el tapón del tubo de inflar.

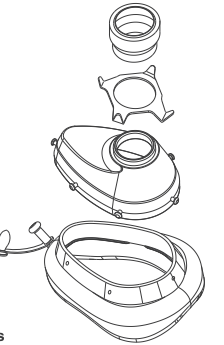

4.2 Limpieza de las partes
Limpieza manual o automática
Lave todas las partes de la mascarilla en agua caliente, con un detergente idóneo para los materiales con que fue construida. Aclare a fondo todas las partes de la mascarilla con agua limpia, a fin de eliminar los restos de detergente.

Al lavar y/o desinfectar la superficie exterior de la mascarilla, cerciórese de que el detergente y/o el desinfectante que emplee sean compatibles con los materiales de la misma. Además, elimine por completo el detergente y/o el desinfectante aclarando con agua con sumo cuidado.

Es posible lavar la mascarilla en una lavadora, que posea un programa especial para aparatos respiratorios que se emplean en Anestesia.

4.3 Desinfección y/o esterilización
Seleccione la desinfección térmica o química, en virtud de los estándares en vigor en su país, en materia de esterilización, de conformidad con la tabla de métodos a aplicar.

Programa de desinfección mediante lavado automático en caliente
Las lavadoras automáticas para aparatos de uso médico, generalmente, poseen programas con ciclos para desinfectar en caliente.

Hervor
Utilice agua limpia. Caliéntela e hierva las partes de la mascarilla durante 10 minutos, para desinfectarla.

Desinfección química
Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante químico, respetando las dosis de dilución y los tiempos de exposición prescritos. Tras desinfectar químicamente la mascarilla, aclare con todo cuidado empleando agua limpia, a efectos de eliminar por completo los restos de desinfectante.

Autoclave
Utilice los aparatos estándar de autoclave con regulación máxima a 134°C.
¡Cuidado! Antes de efectuar el lavado en autoclave, extraiga el tapón del tubo de inflar.

4.4 Secado y enfriado
Antes de volver a montar la mascarilla, aguarde hasta que se seque y/o enfríe por completo.

4.5 Control de las partes
Tras lavar, desinfectar y/o esterilizar las partes de la mascarilla, contrólela prestando suma atención para cerciorarse de que esté en perfectas condiciones y que no esté demasiado gastada. De lo contrario, cambie las partes en cuestión. Algunos métodos pueden decolorar las partes de caucho, pero ello no repercute en la longevidad de la mascarilla. Si se aprecian fisuras u otros indicios de desgaste de los materiales, cambie las partes menoscabadas.

4.6 Ensamblado
Vuelva a montar la mascarilla.

5. Especificaciones técnicas

Peso

Talla 2: aproximadamente 40 g.
Talla 3: aproximadamente 62 g.
Talla 4: aproximadamente 67 g.
Talla 5: aproximadamente 78 g.
Talla 6: aproximadamente 92 g.

Rango de temperatura de conservación: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

PartesMateriales

Cúpula de la mascarilla:Polisulfona o Policarbonato
Manguito de la mascarilla: Goma silicónica
Conector de la mascarilla: Goma silicónica
Gancho:(Acero) inoxidable

Datos para hacer el pedido:

SM-86222(OLD CODE:PS-0126) Mascarilla con cojín de silicona#2: conector ISO 22mm
SM-86232(OLD CODE:PS-0127) Mascarilla con cojín de silicona#3: conector ISO 22mm
SM-86242(OLD CODE:PS-0128) Mascarilla con cojín de silicona#4: conector ISO 22mm
SM-86252(OLD CODE:PS-0129) Mascarilla con cojín de silicona#5: conector ISO 22mm
SM-86262(OLD CODE:PS-0130) Mascarilla con cojín de silicona#6: conector ISO 22mm
SM-86221(OLD CODE:PN-0126) Mascarilla con cojín de silicona#2: conector ISO 22mm
SM-86231(OLD CODE:PN-0127) Mascarilla con cojín de silicona#3: conector ISO 22mm
SM-86241(OLD CODE:PN-0128) Mascarilla con cojín de silicona#4: conector ISO 22mm
SM-86251(OLD CODE:PN-0129) Mascarilla con cojín de silicona#5: conector ISO 22mm
SM-86261(OLD CODE:PN-0130) Mascarilla con cojín de silicona#6: conector ISO 22mm

PS: Plástico de polisulfona
PN: Plástico de policarbonato

NOTA: El policarbonato (PC) no es un material cuya duración se pueda calcular perfectamente de antemano. La duración del producto depende de los métodos de esterilización que se empleen.