GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SUPPORTO A ROTELLE
ROLLING STAND
CHARIOT À ROULETTES
SOPORTE RODANTE
SUPORTE ROLANTE



	REF
GIMA 35127	8030421050
GIMA 35148	8030421049
GIMA 54422	8030421060

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante:
Shenzhen Stone Wisdom Technology Co., Ltd.Room 401,
Building 6, Fanshen Industrial Zone, Yangguang Second Road,
Yangguang Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
mei@stom-pd.com
MADE IN CHINA

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M35127-M-Rev.102.25

Version (Versión): Ver1.2

Fecha: 23 de diciembre de 2024

Instrucciones para el usuario

Para funcionar correctamente y obtener el mejor rendimiento, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este soporte rodante. Este manual describe la instalación, funcionamiento, mantenimiento, transporte y almacenamiento.

¡Por favor conserve este manual para futuras referencias!



1. Características



Ruedas silenciosas con frenos



Cesta con asa y gancho



Altura ajustable



Ángulo de elevación ajustable



Bloqueo de placa de montaje

2. Uso previsto

Este producto está diseñado para trasladar equipos como un monitor de paciente, un monitor de ECG, etc. para ayudar a los médicos a trabajar de forma cómoda y eficaz.

3. Limpieza y desinfección

1. Retire el monitor antes de limpiar el soporte rodante.

2. Se recomienda limpiar el rodillo regularmente. Sólo está permitido el uso de limpiadores no corrosivos. Diluya los productos de limpieza según las instrucciones del fabricante.

3. Utilice un paño con alcohol o el limpiador de su elección para limpiar la superficie del soporte rodante y séquelo con un paño limpio o déjelo secar al aire

4. Especificaciones

Dimensiones: **503*461*H924-1074 mm (altura ajustable)**

Peso (incluido el paquete): **12 kg**

Material:

Tubo superior: **Acero inoxidable**

Tubo inferior: **Aleación de aluminio**

Base: **Aleación de aluminio**

Cesta: **Hierro**

Capacidad de carga total: **30 kg**

5. Transporte y almacenamiento

1. Transporte

El soporte rodante debe dejarse en su embalaje original cuando se transporte y mantenerse seco.

2. Condiciones de almacenamiento:

El soporte rodante debe mantenerse en un lugar seco y debidamente ventilado, libre de polvo y gases corrosivos.

Si el soporte se almacena en su embalaje original, la altura de apilamiento no debe exceder las cuatro capas, el almacén debe estar a temperatura ambiente.

6. Lista de empaque

Kit base *1

Placa de montaje *1

Tubo de soporte *1

Rueda giratoria *4


Herramienta de instalación *1

7. Solución de Problemas

Problema	Análisis	Solución
El tubo de soporte se mueve	Los tornillos de fijación de la base pueden estar flojos	Compruebe los tornillos y apriételos si es necesario
El ángulo de elevación puede ajustarse	Los tornillos de fijación del asa están demasiado flojos / apretados	Ajuste el apriete según las necesidades


8. Solución de Problemas

Instalación

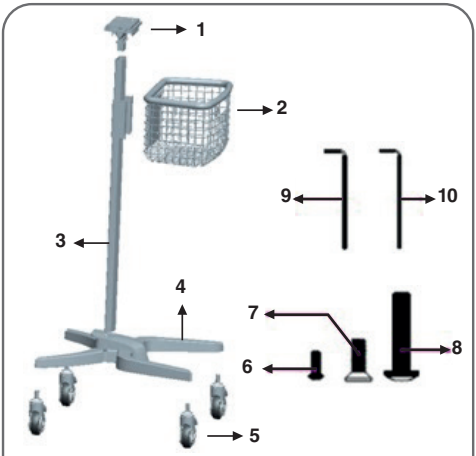



No	Nombre de la pieza	Cant.
1	Placa de montaje	1
2	Cesta de almacenamiento	1
3	Tubo de soporte	1
4	Base	1
5	Rueda giratoria	4
6	Tornillo M4-10/12	8
7	Tornillo M5-16	5
8	Tornillo M6-25	4
9	Llave inglesa de 3mm	1
10	Llave inglesa de 4mm	1

Paso 1:
Fije las cuatro ruedas en los agujeros correspondientes de la base.




Paso 2:
Inserte el tubo de soporte en la base y fíjelo con tornillos M6-25.




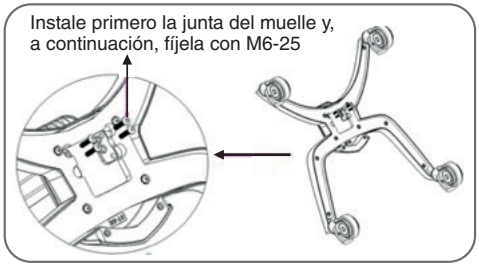

Paso 3:
Ensamble la cesta de almacenamiento y fíjela con los tornillos M4-10 y M4-12 de acuerdo con las siguientes imágenes

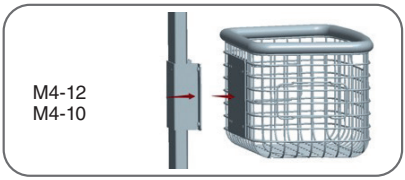

Paso 4:
Fije el soporte en el tubo de soporte y sujételo con tornillos M5-16

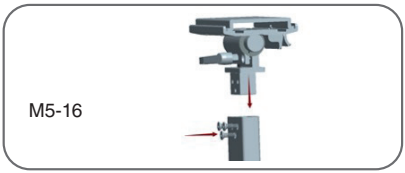

Índice de símbolos

	Consultar las instrucciones de uso	REF	Código producto
LOT	Número de lote		Conservar al amparo de la luz solar
	Conservar en un lugar fresco y seco		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.