GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SUPPORTO A ROTELLE
ROLLING STAND
CHARIOT À ROULETTES
SOPORTE RODANTE
SUPORTE ROLANTE



	REF
GIMA 35127	8030421050
GIMA 35148	8030421049
GIMA 54422	8030421060

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante:
Shenzhen Stone Wisdom Technology Co., Ltd.Room 401,
Building 6, Fanshen Industrial Zone, Yangguang Second Road,
Yangguang Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
mei@stom-pd.com
MADE IN CHINA

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M35127-M-Rev.102.25

Version : Ver1.2

Date : 23 décembre 2024

Instructions pour l'utilisateur

Afin d'utiliser correctement ce dispositif et d'obtenir les meilleures performances, lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce support roulant. Ce manuel décrit l'installation, le fonctionnement, l'entretien, le transport et le stockage.

Conserver ce manuel pour toute consultation future !



1 Caractéristiques



Roulettes silencieuses avec freins



Panier avec anse et crochet



Réglable en hauteur



Angle d'élévation réglable



Blocage de plaque de montage

2 Utilisation prévue

Ce produit est destiné au transfert d'équipements tels que moniteur patient, moniteur ECG etc. pour aider les médecins à travailler de manière fonctionnelle et efficace.

3. Nettoyage et désinfections

1. Retirer le moniteur avant de nettoyer le support roulant.

2. Il est recommandé de nettoyer le chariot régulièrement. Utiliser uniquement des produits nettoyants non corrosifs. Diluer les produits de nettoyage conformément aux instructions des fabricants.

3. Utiliser un chiffon imbibé d'alcool ou du produit nettoyant du propre choix pour essuyer la surface du chariot à roulettes, puis la sécher à l'aide d'un chiffon propre ou la laisser sécher à l'air libre

4. Spécifications

Dimensions : **503x461xH924-1074 mm (auteur réglable)**

Poids (avec emballage) : **12 kg**

Matériau :

Montant supérieur : **Acier inoxydable**

Montant inférieur : **Alliage d'aluminium**

Base : **Alliage d'aluminium**

Panier : **Fer**

Capacité totale : **30 kg**

5. Transport et stockage

1. Transport :

Le chariot à roulettes pour moniteur doit être conservé dans son emballage d'origine lorsqu'il est transporté et maintenu au sec.

2. Conditions de stockage

Le chariot à roulettes pour moniteur doit être conservé dans un lieu sec et bien ventilé, à l'abri de la poussière et des gaz corrosifs.

Si le chariot à roulettes pour moniteur est conservé dans son emballage d'origine, la hauteur d'empilage ne doit pas dépasser quatre couches, et l'entrepôt doit être à température ambiante.

6. Liste de colisage

Kit de la base *1

Plaque de montage*1

Pied de support *1

Roulettes *4


Outil de montage *1

7. Dépannage

Problème	Analisi	Soluzione
Le pied de support vibre	Les vis de fixation de la base sont peut-être desserrées	Contrôlez les vis et les resserrer si nécessaire
Il est possible de régler l'angle d'élévation	Les vis de réglage de la poignée ont trop de jeu ou sont trop serrées	Régler le serrage selon les exigences


8. Installation

Liste des composants

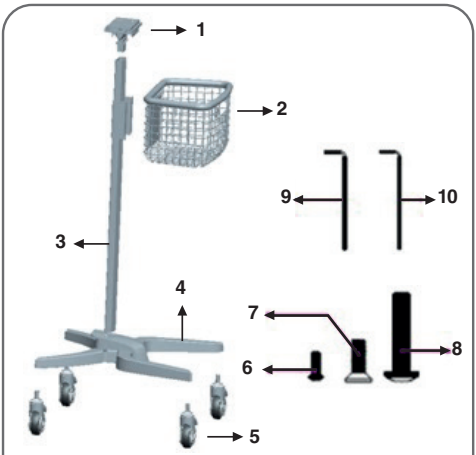



Non	Nom de la pièce	Qté
1	Plaque de montage	1
2	Panier	1
3	Pied de support	1
4	Base	1
5	Roulettes	4
6	Vis M4-10/12	8
7	Vis M5-16	5
8	Vis M6-25	4
9	Clé 3 mm	1
10	Clé 4 mm	1

Étape 1 :
Fixer les quatre roulettes dans les trous de la base prévus à cet effet.




Étape 2 :
Insérer le pied de support dans la base et le fixer à l'aide des vis M6-25.




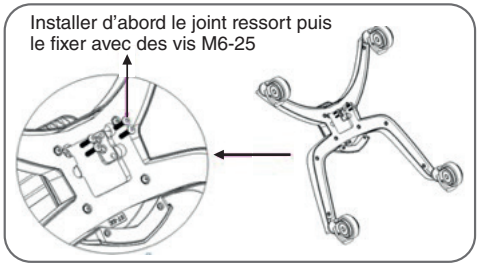

Étape 3 :
Monter le panier et le fixer à l'aide des vis M4-10 et M4-12 comme indiqué dans les images suivantes

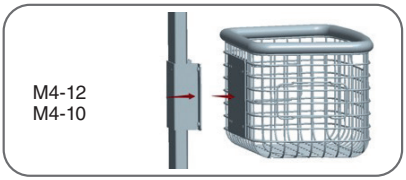

Étape 4 :
Monter le support sur le pied de support et le fixer à l'aide des vis M5-16.

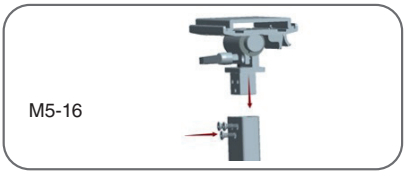

Index des symboles

	Consulter les instructions d'utilisation	REF	Code produit
LOT	Numéro de lot		
	Á conserver dans un endroit frais et sec		Á conserver à l'abri de la lumière du soleil

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.