GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCT

- LAMPADA A LED LUMINA – su carrello
- LAMPADA HYRIDIA A 7 LED con braccio flessibile - su carrello
- Lampada HYRIDIA a 7 LED con braccio flessibile in metallo - su carrello
- LAMPADA A LED SPOT - su carrello

- LUMINA LED LIGHT - trolley
- HYRIDIA 7 LEDS LIGHT with flexible arm - trolley
- YRIDIA 7 LEDS LIGHT with metal spring arm - trolley
- LED SPOT-ADJUSTED LIGHT - trolley

- LAMPE À LED LUMINA - chariot
- LAMPE À 7 LEDS HYRIDIA avec bras flexible - chariot
- LAMPE À 7 LEDS HYRIDIA avec bras à ressort en métal - chariot
- LAMPE À LED 'SPOT-ADJUSTED' - chariot

- LÁMPARA LED LUMINA - base rodable
- LÁMPARA 7 LEDS HYRIDIA con brazo flexible - base rodable
- LÁMPARA 7 LEDS HYRIDIA con brazo de resorte de metal - base rodable
- LÁMPARA LED 'SPOT-ADJUSTED' - base rodable

- LUZ LED LUMINA - trólei
- 7 LUZES LED HYRIDIA - braço flexível - trólei
- 7 LUZES LED HYRIDIA - braço de mola metálico - trólei
- LUZ DE FOCO AJUSTADO LED - trólei

- LED-LICHT LUMINA - Wagen
- LED-LICHT HYRIDIA 7 - flexibler Arm - Wagen
- LED-LICHT HYRIDIA 7 - Metallfederarm - Wagen
- LED-LICHT MIT EINSTELLBAREM LICHTPUNKT - Wagen

- LAMPA LEDOWA LUMINA - wózek
- LAMPA LEDOWA HYRIDIA 7 - ramię elastyczne - wózek
- LAMPA LEDOWA HYRIDIA 7 - metalowe ramię sprężynowe wózek
- LAMPA LEDOWA Z REGULOWANĄ PLAMKĄ - wózek

- ΦΩΤΙΣΜΟΣ LUMINA LED - τροχήλατη βάση
- ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - εύκαμπτος βραχίονας - τροχήλατη βάση
- ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - μεταλλικός βραχίονας με ελατήριο τροχήλατη βάση
- ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - τροχήλατη βάση

- LUMINA LED LIGHT - cărucior
- HYRIDIA 7 LUMINI LED CU BRAȚ FLEXIBIL - cărucior
- HYRIDIA 7 LUMINI LED CU BRAȚ METALIC CU ARC - cărucior
- SPOT LED - LUMINĂ REGLATĂ - cărucior

- LUMINA LED LIGHT - voziček
- HYRIDIA 7 LED LUČK S FLEKSIBILNO ROKO - voziček
- HYRIDIA 7 LED LUČK S KOVINSKO VZMETJO - voziček
- LED TOČKASTA REGULACIJSKA LUČ - voziček

- LUMINA LED SVETLO - pojazdné lôžko
- HYRIDIA 7 LED SVETLO S PRUŽNÝM RAMENOM - pojazdné lôžko
- HYRIDIA 7 LED SVETLO S KOVOVÝM PRUŽINOVÝM RAMENOM - pojazdné lôžko
- LED SPOT-NASTAVITEĽNÉ SVETLO - pojazdné lôžko

- LUMINA LED SVJETLO - kolica
- HYRIDIA 7 LED SVJETLA SA SAVITLJIVIM KRAKOM - kolica
- HYRIDIA 7 LED SVJETLA S KRAKOM S METALNOM OPRUGOM - kolica
- LED SVJETLO PODEŠENO PREMA TOČKI - kolica

- LUMINA LED LÁMPA - kocsi
- HYRIDIA 7 LED LÁMPA RUGALMAS KARRAL - kocsi
- HYRIDIA 7 LED LÁMPA RUGÓS FÉM KARRAL - kocsi
- LED ÁLLÍTHATÓ FÉNYFOLT LÁMPA - kocsi

- LUMINA СВЕТОДИОДНА ЛАМПА - стойка на колелца
- HYRIDIA ЛАМПА СЪС 7 СВЕТОДИОДА С ГЪВКАВО РАМО - стойка на колелца
- HYRIDIA ЛАМПА СЪС 7 СВЕТОДИОДА С РАМО С МЕТАЛНА ПРУЖИНА - стойка на колелца
- СВЕТОДИОДНА ЛАМПА С РЕГУЛИРАЩО СЕ ПОЛЕ НА ОСВЕТЯВАНЕ - стойка на колелца

	REF
GIMA 49035	KS-Q3
GIMA 49040	KS-Q7
GIMA 49041	KS-Q7E
GIMA 49048	KS-Q5-3D

Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd
5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou, China - Made in China

EU REP
SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE

MD

M49035-M-Rev5-09.26

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

1. Εισαγωγή

Η εξέλιξη του ιατρικού φωτισμού

Η ποιότητα του φωτός σε ένα ιατρικό σύστημα φωτισμού εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: τη φωτεινότητα, τη συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος (CCT) και τον δείκτη απόδοσης χρωμάτων (CRI). Αν και αυτές οι παράμετροι έχουν καθοριστική σημασία, η μεμονωμένη αξιολόγησή τους παρέχει μια μη ολοκληρωμένη εικόνα. Η πραγματική τους σημασία έγκειται στην αλληλοεξάρτησή τους, καθώς δεν είναι δυνατόν να μεγιστοποιηθεί μια παράμετρος δίχως να επηρεαστούν και οι υπόλοιπες.

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη γκάμα

Όταν μιλάμε για εξεταστικό φωτισμό εννοούμε διαγνωστικές λάμπες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους επαγγελματίες υγείας να εστιάζουν σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος, με σκοπό την ακριβή παρατήρηση και διάγνωση. Ο φωτισμός αυτός είναι εξοπλισμένος με μεγεθυντικούς φακούς και ψυχρά λευκά LED και προσφέρουν βαθιά και λεπτομερή ορατότητα. Είναι ιδανικός για ιατρεία, γυναικολογικές και δερματολογικές κλινικές, μικρές χειρουργικές επεμβάσεις, αισθητικές θεραπείες, κτλ.


Οι εν λόγω λάμπες, με την εξαιρετική ποιότητα φωτισμού που διαθέτουν, εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή του φωτός, ελαχιστοποιώντας τις σκιές και βελτιώνοντας την ορατότητα σημαντικών λεπτομερειών. Η ρυθμιζόμενη ένταση φωτός και θερμοκρασία χρώματος επιτρέπουν την προσαρμογή του φωτισμού έτσι ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις οποιασδήποτε ιατρικής εφαρμογής, προσφέροντας βέλτιστη άνεση τόσο στους γιατρούς όσο και στους ασθενείς.

Κατασκευασμένες από ανθεκτικά υλικά που καθαρίζονται εύκολα, αυτές οι εξεταστικές λάμπες έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε εντατική χρήση, πληρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής. Οι προηγμένες τεχνολογίες, όπως τα βελτιστοποιημένα συστήματα απαγωγής θερμότητας, εγγυώνται παρατεταμένη χρήση δίχως να επηρεάζεται η απόδοση ή η αξιοπιστία.


Χάρη στον εργονομικό και ευέλικτο σχεδιασμό τους, οι ιατρικές εξεταστικές λάμπες μπορούν να ενσωματωθούν απόλυτα σε οποιοδήποτε κλινικό ή εξωτερικό περιβάλλον, προσφέροντας ανώτερη πρακτικότητα και ευκολία στη χρήση.

Τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων των MDR 2017/745, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-2-41


2. Τεχνικά Δεδομένα




49035



49040



49041



49048


Μοντέλο	Σειρά **49035** KS-Q3	Σειρά **49048** KS-Q5-3D	Σειρά **49040-49041** KS-Q7/Q7E
Χρώμα	Μαύρο/ Λευκό	Μαύρο	Λευκό / Πορτοκαλί
Πηγή φωτός	1 x λαμπτήρα LED, 10VA	1 x λαμπτήρα LED, 10VA	7x λαμπτήρες LED, 35VA
Διάμετρος κεφαλής φωτισμού	75 mm	25 mm	89 mm
Διάμετρος πεδίου φωτισμού	100-150 mm (30-50 cm)	10-110 mm (50 cm) Μεταβλητή	90-120 mm (30-50 cm) 120-200 mm (50-100 cm)

Φωτισμός	100.000 Lux (30 cm) 40.000 Lux (50 cm)	40.000 Lux (30 cm) 15.000 Lux (50 cm)	170.000 Lux (30 cm) 80.000 Lux (50 cm)
Εύκαμπτος βραχίονας	760 mm	1200 mm	760 mm / 940 mm
Έλεγχος φωτεινότητας	Dimmer/ με αφή (D)/χωρίς αφή (S)/ μπαταρία(B)		Πίεση με αφή Επιλογή: κουτί μπαταρίας(LB)
Τύπος εγκατάστασης	Κινητός / Επιλογαές: Επιτοίχια εγκατάσταση, Σύσφιξη σε ράγα, σύσφιξη σε τραπέζι		Κινητός / Επιλογές: Επιτοίχια εγκατάσταση, σύσφιξη σε ράγα, σύσφιξη σε τραπέζι, Εγκατάσταση σε ταβάνι (LA-6, Q7-02A,Q10, 1088, 200)


3. Περιγραφή προϊόντος

Α. Επάνω μέρος συμπεριλαμβανομένης κεφαλής φωτισμού, εύκαμπτου βραχίονα, κουτιού ελέγχου


49035 - KS-Q3
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LUMINA LED - τροχήλατη βάση

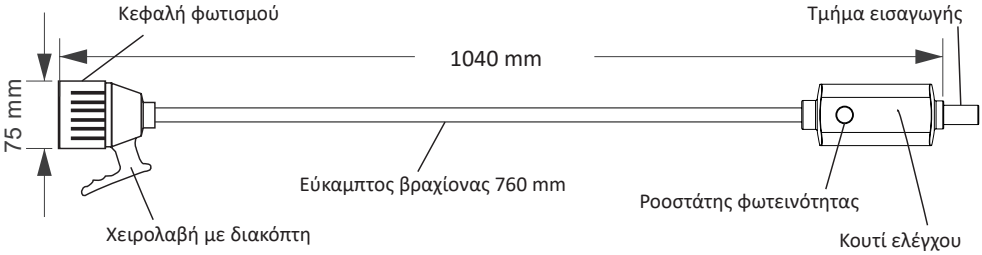


49040 - KS-Q7
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - εύκαμπτος βραχίονας - τροχήλατη βάση

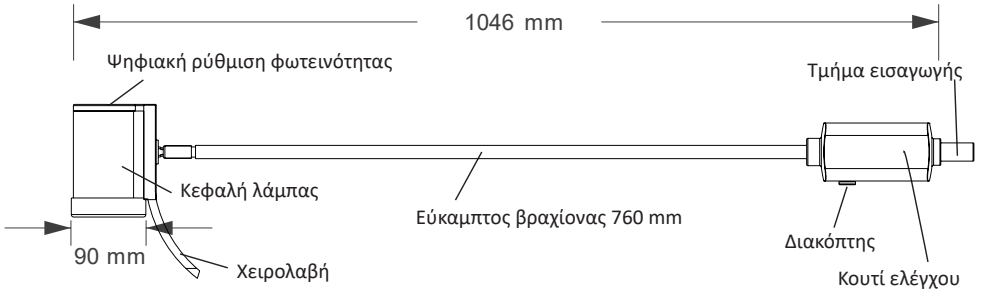

49041 - KS-Q7E
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - μεταλλικός βραχίονας με ελατήριο - τροχήλατη βάση

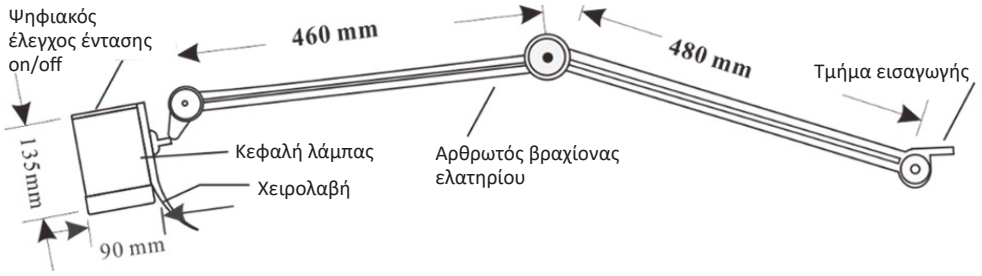


49048 - KS-Q5-3D
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - τροχήλατη βάση

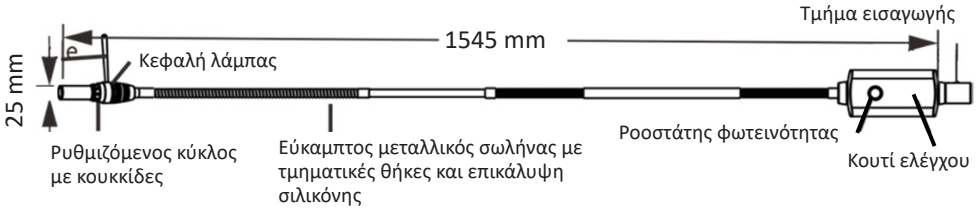


Β. Τύπος Εγκατάστασης φωτισμού

Β.1 Στάνταρ τροχήλατο για σειρά KS-Q3, KS-Q35




Κωδικός βάσης	ABS01 Μαύρο / ABS02 Λευκό
Υλικό	Ενσωματωμένο πλαστικό
Τροχοί	D=50 mm με 5 φρένα
Βάση	D=530 mm, 5 πόδια στήριξης, 1,5kg
Κάθετος στύλος	L=850 mm

Β.2 Στάνταρ τροχήλατο για σειρές KS-Q5, Q5N, KS-Q6







Κωδικός βάσης	DM01 Μαύρο/ Λευκό
Υλικό	Χάλυβας με ηλεκτροστατική βαφή
Τροχοί	D=50 mm με 5 φρένα
Βάση	D=580 mm, 5 πόδια στήριξης, 3,4kg
Κάθετος στύλος	L=600 mm / 850 mm

Β.3 Στάνταρ τροχήλατο για σειρές KS-Q7/Q7 02A/Q7E, KS-LA-6D,KS-Q10-02

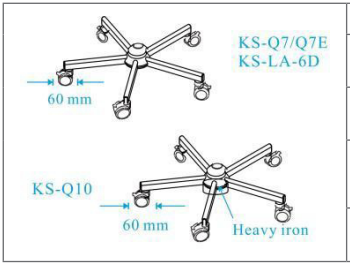

Κωδικός βάσης	DM02 Μαύρο / Λευκό
Υλικό	Χάλυβας με ηλεκτροστατική βαφή
Τροχοί	D=60mm με 5 φρένα
Βάση	D=580mm, 5 πόδια στήριξης, 3,4kg / 6kg (DM03)
Κάθετος στύλος	L=850mm

Β.4 Πρόσθετα εξαρτήματα εγκατάστασης

Επιτοίχιο στήριγμα εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο	Σφιγκτήρας εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο		Ράβδος εγκατεστημένη σε ταβάνι
			

4. Εγκατάσταση και ρυθμίσεις

4.1. Ελέγξτε το κύριο σώμα του προϊόντος και επιβεβαιώστε την παροχή τροφοδοσίας


Ανοίξτε τη συσκευασία και επαληθεύστε την ακεραιότητα του προϊόντος. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον διανομέα. Αφαιρέστε τη λάμπα από τη συσκευασία, συνδέστε την στο ρεύμα και ανάψτε την.

4.2. Εγκατάσταση τροχήλατης βάσης

Α. Πλαστική κινητή βάση:

Τοποθετήστε τους 5 πλαστικούς τροχούς στα πέντε πόδια στήριξης της βάσης. Βγάλτε τον κάθετο μεταλλικό σωλήνα, τοποθετήστε τον στην κεντρική οπή της πλαστικής βάσης και ασφαλίστε τη μακρύτερη βίδα από το κάτω μέρος στο κέντρο (Βλ. εικόνα 1)

εικόνα 1

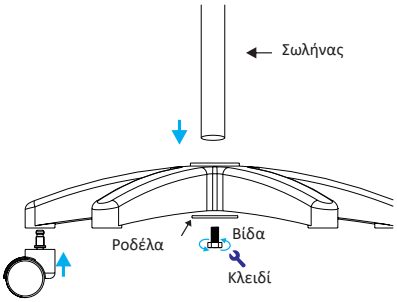


Β. Μεταλλική αποσπώμενη βάση:

Βγάλτε τα πόδια στήριξης και βιδώστε τους τροχούς. Έπειτα, τοποθετήστε τα πόδια στήριξης στις υποδοχές του πλαστικού συνδετικού εξαρτήματος, τοποθετήστε το μεταλλικό συνδετικό εξάρτημα από το κάτω μέρος και βιδώστε τα μπουλόνια για να στερεώσετε τα πόδια στο συνδετικό εξάρτημα.

Τέλος, τοποθετήστε τον κάθετο μεταλλικό σωλήνα στο πλαστικό συνδετικό εξάρτημα (αν πρόκειται για το μοντέλο DM03, τοποθετήστε το πρόσθετο σιδερένιο εξάρτημα από το κάτω μέρος της βάσης) και ασφαλίστε τη μακρύτερη βίδα από το κάτω μέρος στο κέντρο. (Δείτε εικόνα 2)

εικόνα 2

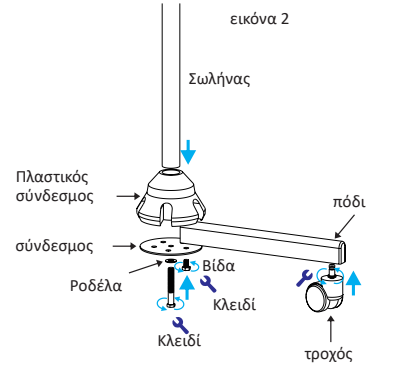

4.3. Επιτοίχια εγκατάσταση:

τοποθετήστε τη βίδα στερέωσης στον τοίχο και βιδώστε το εξάρτημα στήριξης στον τοίχο αντιστοιχώντας τις οπές.

4.4. Σύσφιξη σε τραπέζι:

τοποθετήστε αυτό το εξάρτημα στο τραπέζι από την άκρη του τραπεζιού και βιδώστε σφιχτά από κάτω.

4.5. Σύσφιξη σε ράγα:

ξεβιδώστε τη ράβδο, τοποθετήστε το άνω και το κάτω εξάρτημα ολίσθησης έτσι ώστε να στερεωθεί η ράβδος της ράγας και βιδώστε σφιχτά από κάτω.

4.6. Εγκατάσταση σε ταβάνι

Γυρίστε προς τα κάτω τον σταθερό δακτύλιο του πάνω καλύμματος, τοποθετήστε τον σύμφωνα με την οπή τοποθέτησης της πάνω βίδας, τοποθετήστε τη βίδα διαστολής και εγκαταστήστε το πάνω μέρος σύμφωνα με τη θέση της βίδας διαστολής. Υπάρχει μια πρίζα τροφοδοσίας υψηλής τάσης (Προσοχή: AC:110-240V) στο πάνω μέρος. Αφού τοποθετηθεί το πάνω μέρος, η γραμμή τροφοδοσίας συνδέεται με το δίκτυο AC από το ταβάνι και βιδώνεται ξανά ο δακτύλιος στερέωσης του πάνω καλύμματος.

Μετά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, τοποθετείται το πάνω μέρος, αφαιρείται το άνω τμήμα της λάμπας, εισάγεται στην οπή τοποθέτησης του βραχίονα της μονάδας φωτισμού και έπειτα εισάγεται στο βύσμα DC που βρίσκεται δίπλα στην οπή τοποθέτησης. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η εγκατάσταση.


4.7. Τοποθετήστε το κύριο άνω σώμα στο πάνω μέρος του κάθετου μεταλλικού σωλήνα, βιδώνοντας σφιχτά από το πλάι, συνδέστε το βύσμα στην πρίζα του ρεύματος και ενεργοποιήστε για να αρχίσει να λειτουργεί.

5. Χρήση και λειτουργία


5.1. Ρύθμιση θέσης κεφαλής φωτισμού:

Κρατήστε την κεφαλή φωτισμού με το ένα χέρι, κρατήστε το σύστημα της κάθετης στήλης με το άλλο χέρι και τραβήξτε την κεφαλή φωτισμού για να προσαρμόσετε τη θέση της.


5.2. Ρύθμιση φωτεινότητας



KS-Q35/Q3/Q5/Q5N/Q6:
Κουτί ελέγχου για μείωση της φωτεινότητας.
Περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα



KS-Q3D/Q5-3D/Q5-3B/Q5N-3D/ Q5N-3B/Q6D/Q6B:
αγγίξτε ελαφρώς το ▲ στο κουτί ελέγχου για αύξηση ή το ▼ για μείωση της φωτεινότητας, το εύρος ρύθμισης είναι 1-5 και εμφανίζεται στην οθόνη LED.



KS-LA-6D / KS-LA-6B:
αγγίξτε ελαφρώς το ▲ στο κουτί ελέγχου για αύξηση ή το ▼ για μείωση της φωτεινότητας, το εύρος ρύθμισης είναι 1-5 και εμφανίζεται στην οθόνη LED.



Σειρά KS-Q7/Q7-02A/Q7E:
Ψηφιακό πληκτρολόγιο ▲ στην κεφαλή φωτισμού για αύξηση ή ▼ για μείωση της φωτεινότητας

6. Συνθήκες Λειτουργίας

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 5°C~+40°C

Σχετική Υγρασία: <85%

Ατμοσφαιρική Πίεση: 700hPa~1060hPa

7. Παρατήρηση

1. Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέστε πρώτα το καλώδιο ρεύματος.

2. Δεν επιτρέπεται η χρήση υγρού απορρυπαντικού για τον καθαρισμό.

3. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

4. Προτού αντικαταστήσετε τον καμένο λαμπτήρα, θα πρέπει να αποσυνδέσετε την εξεταστική μονάδα φωτισμού από το ρεύμα.

5. Η εγκατάσταση, η αντιμετώπιση προβλημάτων και η ρύθμιση πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματικό προσωπικό.

6. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο

7. Αποθήκευση των Μπαταριών

Οι μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου και το επίπεδο φόρτισής τους να είναι περίπου στο 30%-50% της χωρητικότητάς τους. Συνιστάται να φορτίζετε τις μπαταρίες περίπου μία φορά κάθε έξι μήνες, προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολική εκφόρτισή τους.

8. Εγγύηση και Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

8.1. Εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αποστολής

- Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης (εφόσον το ελάττωμα οφείλεται στην ποιότητα του προϊόντος), ο καταναλωτής δικαιούται δωρεάν συντήρηση, κατόπιν προσκόμισης του δελτίου εγγύησης και του τιμολογίου. Σε περίπτωση εγκατάστασης άλλων εξαρτημάτων, δίχως τη σχετικη έγκριση του κατασκευαστή, το ελάττωμα δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Σε περίπτωση που οι σημάνσεις επάνω στο προϊόν, όπως ο αριθμός μοντέλου ή η ημερομηνία κατασκευής, έχουν τροποποιηθεί, σβηστεί, μετακινηθεί ή δεν είναι αναγνωρίσιμες, παύει να ισχύει η δωρεάν υπηρεσία συντήρησης.
- Βλάβες που προκαλούνται από πτώση, σύνθλιψη, βύθιση σε υγρό, υγρασία και άλλους ανθρώπινους παράγοντες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

8.2. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Οι πελάτες πρέπει να παρέχουν τους κωδικούς των προϊόντων, καθώς και φωτογραφία ή βίντεο προκειμένου να επιβεβαιωθεί το πρόβλημα. Εφόσον το πρόβλημα επιβεβαιωθεί, εάν η επίλυσή του είναι εύκολη, αποστέλλουμε το ανταλλακτικό στον πελάτη. Εάν το πρόβλημα δεν δύναται να επιλυθεί, προβλέπεται επιστροφή ή εκ νέου αποστολή.

9. Καθαρισμός και Απολύμανση:

9.1. Κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση αυτού του προϊόντος, αποσυνδέστε πρώτα την ηλεκτρική τροφοδοσία και φροντίστε να μην εισχωρήσει υγρό στο εσωτερικό της λάμπας. Η απολύμανση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς υγιεινής και απολύμανσης. Ο φακός της κεφαλής φωτισμού δεν πρέπει να τρίβεται ή να καθαρίζεται με απορρυπαντικά υψηλής αλκαλικότητας, βενζόλιο, βενζίνη, ακετόνη, τετραχλωράνθρακα ή οξικό βουτυλεστέρα. Για τον καθαρισμό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ένα μαλακό πανί καθαρισμού. Σκουπίστε και απολυμάνετε με μια καθαρή, απολιπασμένη γάζα εμποτισμένη με μικρή ποσότητα οινοπνεύματος 75%.

9.2. Συνιστώμενα Απολυμαντικά

Η απολύμανση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς υγιεινής και απολύμανσης.
Απολυμάνετε τον εξοπλισμό σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του νοσοκομείου σας. Συνιστάται ο καθαρισμός του εξοπλισμού πριν από την απολύμανση. Παραδείγματα συνιστώμενων προϊόντων απολύμανσης:

Ονομασία Προϊόντος	Τύπος προϊόντος	Κατασκευαστής
Meliseptol® Wipes sensitive	Μαντηλάκια	B. Braun Company
Dismozon® plus	Μαντηλάκια	BODE Chemie GmbH
Mikrobac® Tissues	Μαντηλάκια	BODE Chemie GmbH
Metrex CaviCide1 TM	Υγρό, σπρέι	METERX® RESEARCH

10. Απόρριψη των προϊόντων:

Το προϊόν περιέχει ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα· στο εσωτερικό του και επομένως είναι υποχρεωτικό να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, όπως ορίζεται από την Οδηγία 2012/19/ΕΕ.

11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το κουμπί είναι ενεργοποιημένο, αλλά ο φωτισμός δεν ανάβει	Ο προσαρμογέας δεν είναι σωστά συνδεδεμένος	Ελέγξτε τον προσαρμογέα
		Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος
	Δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία	Ελέγξτε την πηγή τροφοδοσίας AC
	Ελαττωματικό PCB	Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή
Η φωτεινότητα δεν μπορεί να ρυθμιστεί	Ελαττωματικό PCB	Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή

12. Σύμβολα

CE	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745	REF	Κωδικός προϊόντος		Διάθεση WEEE

	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)	LOT	Αριθμός παρτίδας		Ισχύει η κατηγορία II
	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης		Παραγωγός		Ημερομηνία παραγωγής
	Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία	MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Εισαγωγή από	EU REP	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση	UDI	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
SN	Σειριακός αριθμός		Ανακύκλωση		Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
	αυτή είναι η πάνω πλευρά		Εύθραυστο, χειρίζεστε με προσοχή		Προειδοποίηση



ΧΩΝΕΥΣΗ: *Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζύ με άλλα απορρύματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τες σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.*

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.